

دستورالعمل انتشار محتوا در سایت ansarclinic.com

لطفا انتشار هر گونه محتوا در سایت درمانگاه بر اساس قوانین و چارچوب‌های مشخصی که در ادامه آمده‌اند، انجام شود.

○ اسلایدر صفحه اصلی:


اسلایدر صفحه اصلی در سایت درمانگاه باید در 2 سایز مخصوص موبایل و دسکتاپ طراحی شود.

دستگاه	سایز به پیکسل
دسکتاپ	1920*900
موبایل	850*655

○ بنر زیر اسلایدر صفحه اصلی:

بنر زیر اسلایدر صفحه اصلی مخصوص اطلاع رسانی‌ها و بنری ثابت است.

سایز این بنر 1920*300 است.

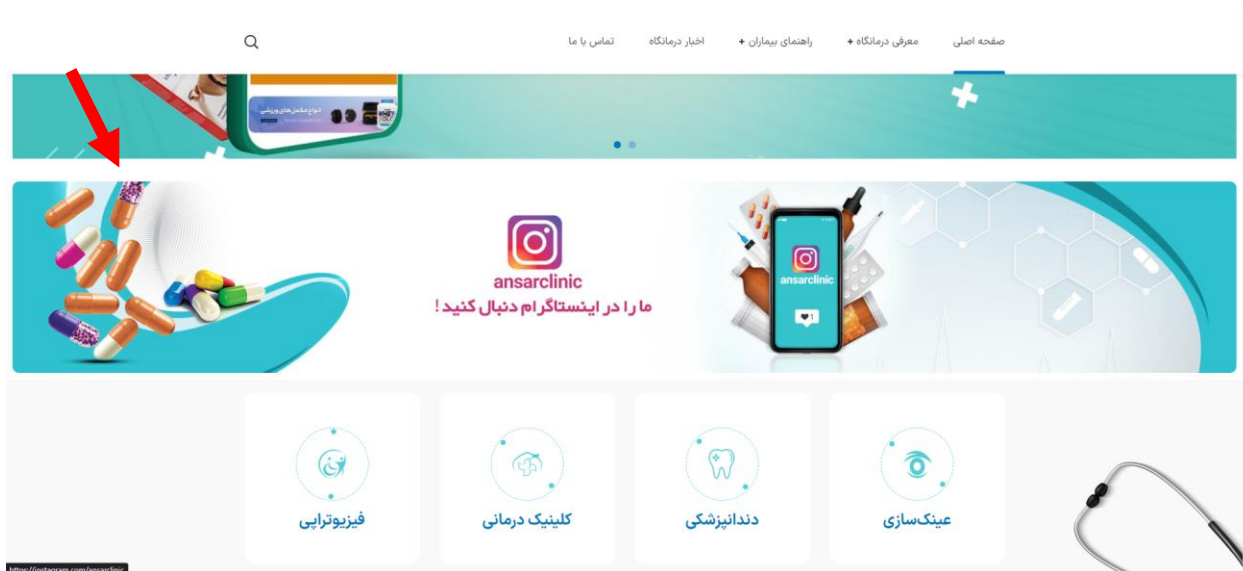

○ کاور مقالات و اخبار سایت:

سایز تصاویر اصلی (کاور) مقالات و اخبار سایت 815*600 پیکسل است.



○ تصویر پزشکان:

تصویر پزشکان در سایز 1000*1000 پیکسل و به شکل مربع است.

در هنگام طراحی تصاویر پزشکان علاوه بر سایز تصویر، به محل قرارگیری تصویر پزشک که در زیر مشخص شده است، هم دقت فرمایید.

